

ARTL 0011

(4849)


COPIA ALLE ISCRIZIONI

ORTSPOLIZEI - POLIZIA LOCALE
KOMMANDO KARNEID - COMANDO CORNEDO
Karnelderstr. 2 - Via Cornedo
KARNEID 39053 CORNEDO ALL'ISARCO

LIBRETTO METROLOGICO DELL'ETILOMETRO

Dräger Safety

ALCOTEST 7110 MKIII

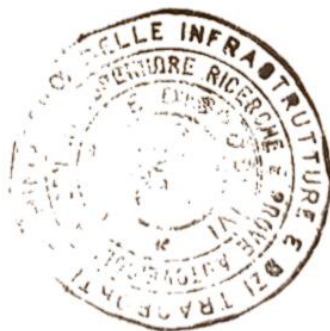

1° homolog. 10/11/1999

DECRETO MINISTERIALE 22.5.1990, n° 196

fornito 19/6/2017
V. N. 40

3?

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato

OM **00308Bet**

del **10.11.1999**

Tipo: **ALCOTEST 7110 MKIII**


N° di serie: **ARJL 0011**

Dichiarazione n°:

Data:



(Firma)

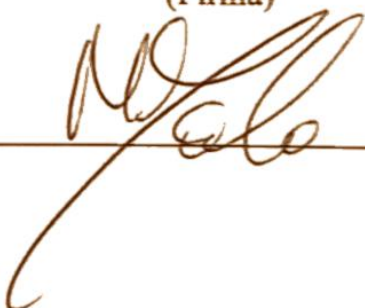
_____ (1)

(1) depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / PERIODICA (*)

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI

Via M. U. Traiano, 40

20149 MILANO

LABORATORIO:

DATA:

26 OTT 2023

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore banco	Esito della verifica periodica				ARJL0011
	[mg/l] [g/l]	1,5l in 5s paller 3s	3l in 5s paller 3s	4,5l in 5s paller 3s	3l in 5s paller 1,5s	
0,000	0,000 0,000		B			
0,200	0,200 0,460		B			
0,350	0,349 0,804		B			
0,400						
0,700	0,699 1,609		B			
0,950						
1,500	1,501 3,452		B			
2,500	B=risultati esatti; E=risultati che superano l'errore max CPA Milano, coordinato col C.S.R.P.A.D. di Roma					K 910
Milano		26/10/2023				

riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/~~RESPINTO~~ (*)



(*) Cancellare l'indicazione inutile



(firma del responsabile del laboratorio)